


曲線美とバリューへの追求。

審美性とスロットの滑りに定評のあるWIOCEのボンディング及びディボンディング性を改良、またレベリング時、リトラクション時における結着性を向上しました。片側のタイウイングへの結紮、リガチャーワイヤーの上からのチェーンの使用も容易になりました。

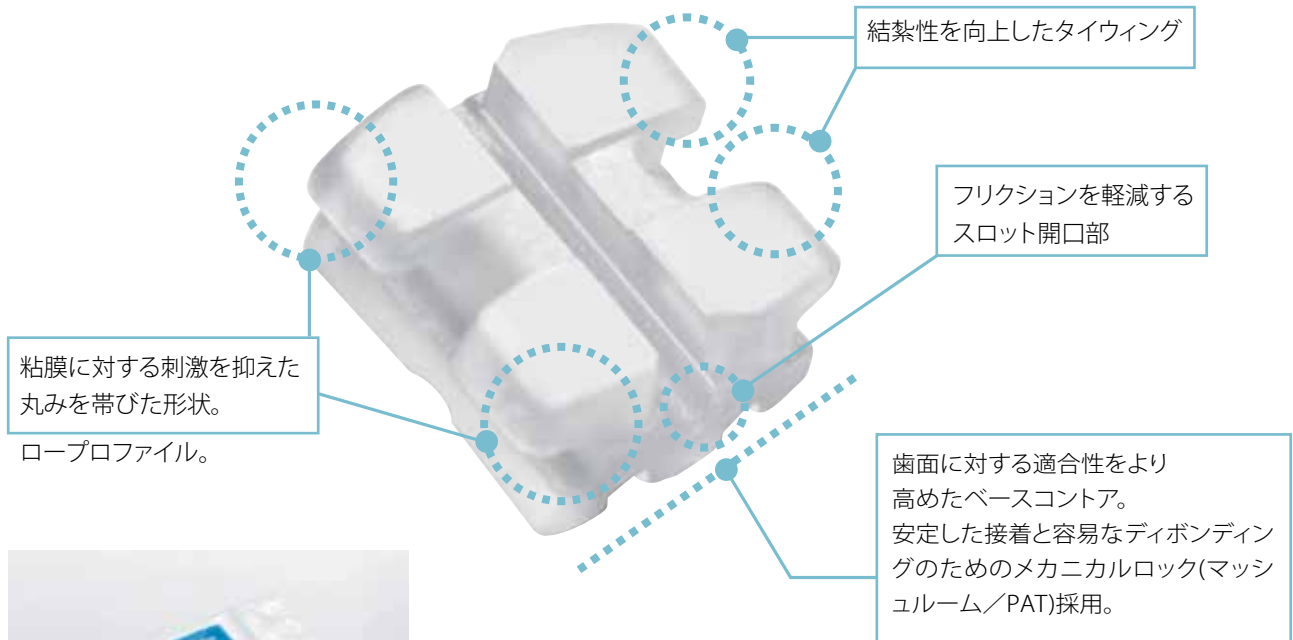

ブラケット・マーキング色

	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
R	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	L		

注1:左右の区別があるブラケット→遠心歯頭部のみにマーキング。
注2:左右の区別がないブラケット→歯頭部の近遠心両方にマーキング。

ワイロス セラミックブラケット

医療機器製造販売認証番号:218ADBZX00015000

品番	部位	ロスタイプ				トルク	アングル	スタンダードタイプ	
		.018		.022				.018	.022
		右	左	右	左			左右共通	左右共通
1		W88015	W88016	W88039	W88040	+12°	+5°	W88001	W88005
2		W88017	W88018	W88041	W88042	+8°	+9°	W88002	W88006
3	フック無	W88019	W88020	W88043	W88044	0°	+11°	W88003	W88007
	フック付	W88021	W88022	W88045	W88046	0°	+11°		
4 5	フック無	W88124		W88148		-7°	0°	W88103	W88107
1 2	ツイン	W88064		W88066		0°	0°	W88064	W88066
3	フック無	W88027	W88028	W88051	W88052	-11°	+5°	W88003	W88007
	フック付	W88029	W88030	W88053	W88054	-11°	+5°		
4	フック無	W88031		W88055		-17°	0°	W88103	W88107
5	フック付	W88035		W88059		-22°	0°		

医療機器認証番号:218ADBZX00015000

キット	ロスタイプ		スタンダードタイプ	
	.018	.022	.018	.022
3~3	W318R+	W322R+	W318S+	W322S+
3~3 (3番フック付)	W318RH+	W322RH+		
5~5	W518R+	W522R+	W518S+	W522S+
5~5 (5番フック付)	W518RH+	W522RH+		

症例キット
3~3キット
12個入 / 1パック12,000円
5~5キット
20個入 / 1パック20,000円

